

ALESAMETRI ART. SICUTOOL 4423E/F/L/M

Letture 1/100 di mm

Aste intercambiabili in acciaio inossidabile, rettificate.


Impugnatura nichelata. Parti di contatto temprate.

In astuccio.

Art.	4423E	4423F	4423L	4423M
Per diametri interni da mm.	15 a 35	30 a 100	50 a 170	100 a 300
Per profondità fino a mm	130	210	210	210

Senza comparatore

È consigliato l'uso con comparatore Art.4404 GB.

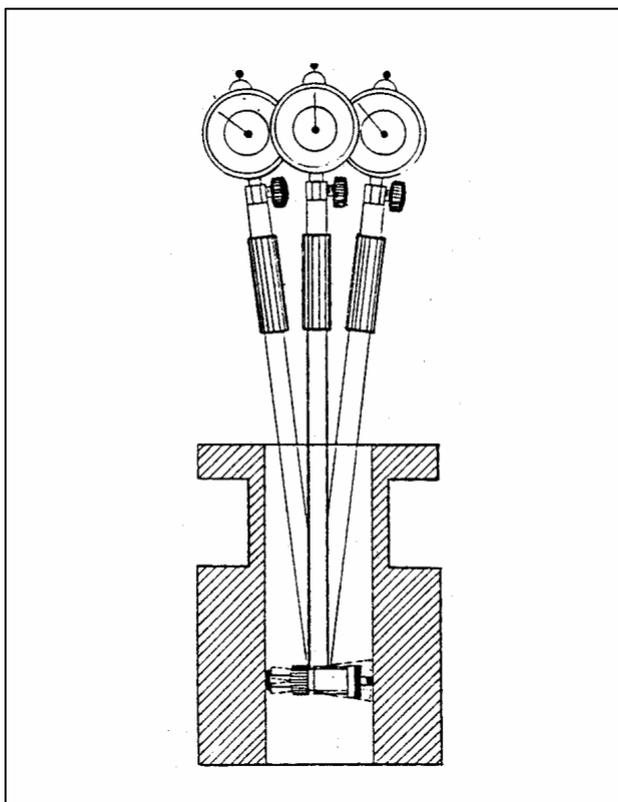

Gli alesametri sono strumenti di comparazione e non di misura diretta, pertanto devono essere tarati prima di essere utilizzati.

La taratura deve essere eseguita con un anello di riscontro avente un diametro interno ± 1 mm rispetto al diametro da controllare.

SISTEMA DI TARATURA

Introducendo l'alesametro nell'anello gli si imprime un movimento oscillatorio (come nel disegno accanto)

La lancetta inverte il suo movimento: questo è il punto preciso che corrisponde al diametro dell'anello e su tale punto si azzerava il comparatore.